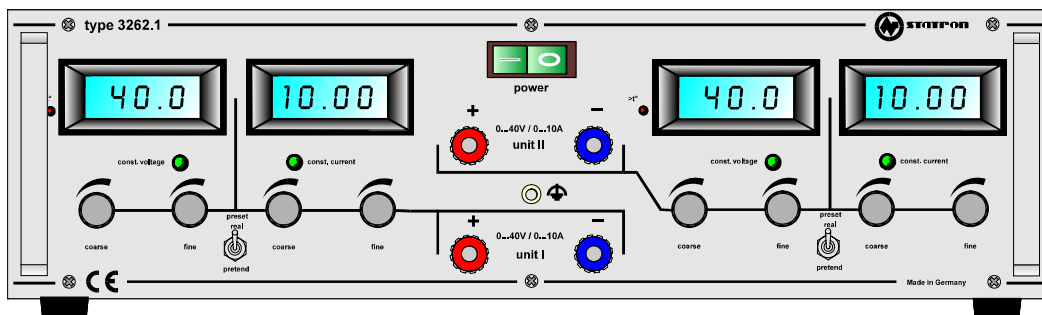


Popis

- lineární regulace
- zkratuvzdorné
- automatický přechod provozu přístroje CV/CC
- testovací tlačítko pro nastavení omezení proudu (regulace proudového omezení)
- chlazení vzduchem (ventilátor)
- výstup oddělený od země

CV = constant voltage (zdroj konst. napětí)
 CC = constant current (zdroj konst. proudu)


techn. parametry

Specifikace		Typ		3262.1			3262.3	
DC	výstupní napětí	0-40V	0-40V			0-80V	0-80V	
DC	výstupní proud	0-10A	0-10A			0-5A	0-5A	
	CV stabilita (sítě +6/-7%)	1mV	1mV			1mV	1mV	
	CV stabilita (zátěž 0-100%)	3mV	3mV			3mV	3mV	
	CV zvlnění (Ueff)	2mV	2mV			2mV	2mV	
	CC stabilita (sítě +6/-7%)	1mA	1mA			1mA	1mA	
	CC stabilita (zátěž 0-100%)	2mA	2mA			2mA	2mA	
	CC zvlnění (I eff)	4mA	4mA			4mA	4mA	
	reg. čas při zátěži 10-100%	200μs	200μs			200μs	200μs	
	regulační prvky Ua / Ia	U/I 2x potenciometr 270° (hrubě a jemně)						
	rozlišení	0,05% z max. rozsahu						
	výstupní charakteristika	U / I						
	ukazatele	digitální ukazatele pro U a I (3-místný LCD), na přání analogové třídy 5						
	výstup	4 mm přístr. svorky				4 mm bezpečnostní přístrojové svorky		
	provozní teplota	0 - 35°C						
	max. relativní vlhkost	85% při 35°C						
AC	vstupní napětí	230 V +6% / -7% 48-62Hz						
AC	zkoušecí napětí	vstup -zem 1,5kV AC; vstup - výstup 1,5kV AC; výstup - zem 500V AC						
	třída přístroje	I.						
	krytí	IP 30						
	vyrobeno podle norem	DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 díl 11 křívka B						
	rozměry Š x V x H (mm)	451x134x410						
	hmotnost	23 kg						

Váš dodavatel:
MERATEST s.r.o., nám. Em. Zahna 168, Květná, 687 66 Strání

Mob.: +420 721 173 293, Tel.: +421 32 642 0909

 e-mail: info@reviznipristroje.cz, web: reviznipristroje.cz
při objednávání uveďte

- označení typu + popř. číslo volby